


< 検査試薬変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、プロトンビン時間(PT)におきまして、国際標準試薬との感度指数(ISI)が1.00により近い高性能試薬に変更させていただきます。
尚、基準値・検査法等の変更はございません。
誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程宜しく
お願い申し上げます。

敬具

記

実施期日 平成 22年 8月 2日(月) 受付分より実施

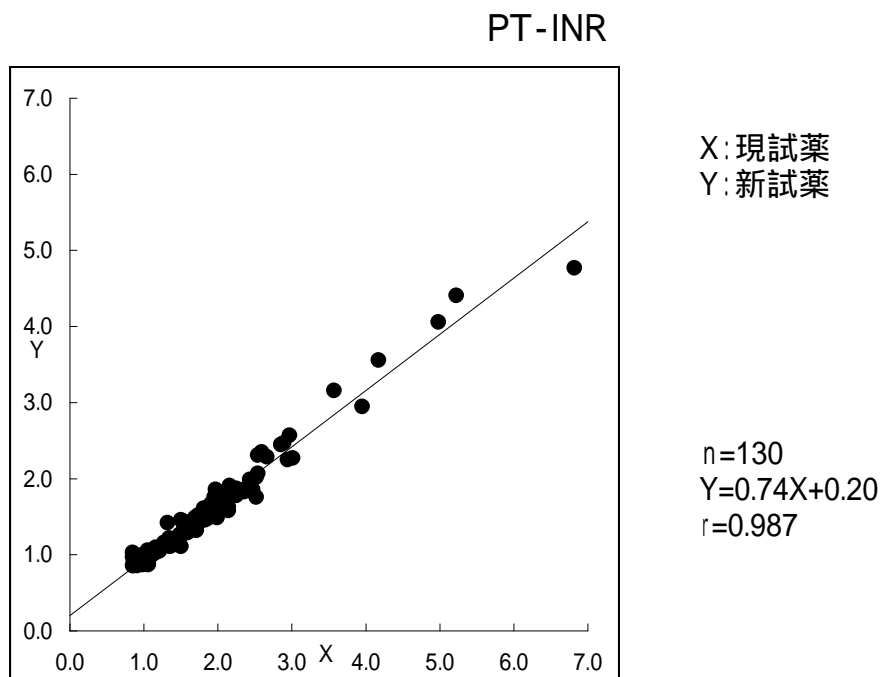

ISI: International Sensitivity Index
(国際感度指数)