

< 基準値変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、下記の項目につきまして測定試薬の変更に伴い基準値を変更させて頂きますので、ご案内申し上げます。
 誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記



実施期日 平成 23年 2月17日(木) 受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更内容	新	旧	備考
697	テストステロン(血清)	基準値	M:1.31~8.71ng/mL	M:2.84~7.99ng/mL	改良試薬への変更
			F:0.11~0.47ng/mL	F:0.06~0.82ng/mL	

*総合検査案内 69頁参照

*改良試薬は女性検体においてDHEAの影響による非特異反応を軽減させた特異性の高い試薬です。

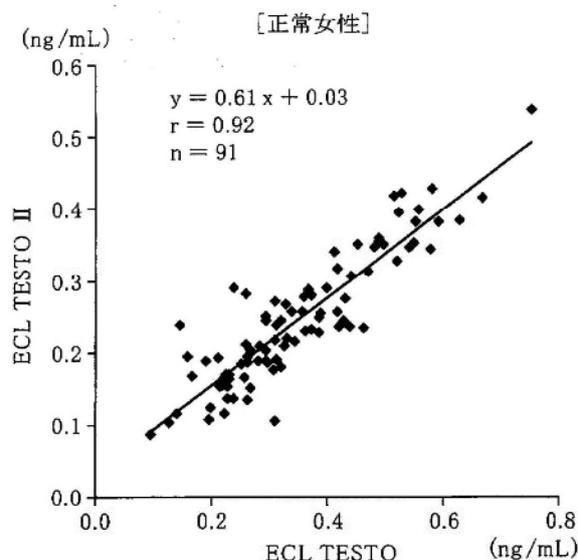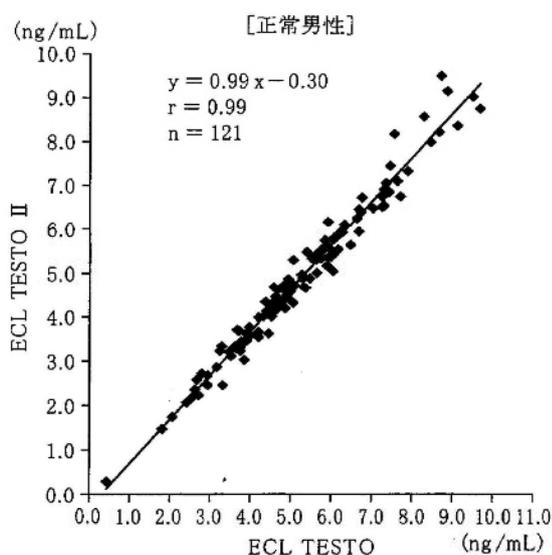

参考文献: 木内 理世、他 医学と薬学64(1):87~93、2010