

< 基準値変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記の項目につきまして測定試薬の変更に伴い検査方法、基準値を変更させて頂きますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、ご了承の程お願い申し上げます。

敬具


記

実施期日 平成23年9月20日(火) 受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更内容	新	旧	備考
3220	D-Dダイマー	検査方法	LIA法	LPIA法	試薬変更に伴う 検査方法、基準値の変更
		基準値	1.00 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下	0.72 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下	

*総合検査案内 128頁参照

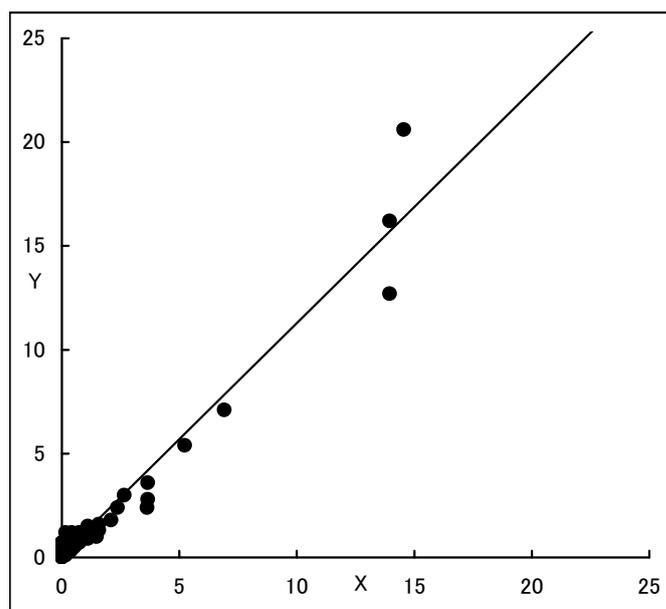

X: 現試薬
Y: 新試薬

n: 71
Y=1.12X+0.10
r=0.975

($\mu\text{g}/\text{mL}$)