

< 検査内容変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記項目は検査を外部委託しておりましたが、このたび弊社で検査を実施することとなりました。これに伴い、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

《変更内容》

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考	検査案内記載頁
342	扁平上皮癌関連抗原 (SCC抗原)	検査方法	FEIA	CLIA	検査機関変更に伴う測定試薬の変更	86
		検体量	血清 0.5mL	血清 0.4mL		
		所要日数	1~2日	2~5日		
		検査機関	京浜予防医学研究所	保健科学研究所		
		検査実施料	112点 (「D 0093」)			
判断料	144点 (生化学的検査(Ⅱ))					


※ 基準値の変更はございません。

現法と新法の比較については裏面をご参照ください。

《実施日》

平成 28年3月1日 (火) 受付分より

SCC抗原 新法と現法の比較

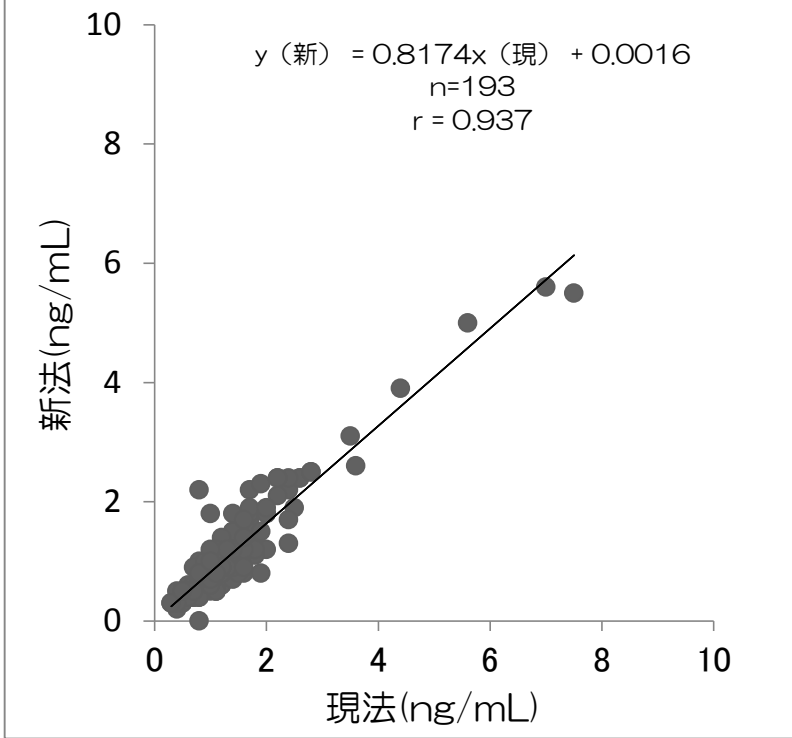

(自社検討資料)